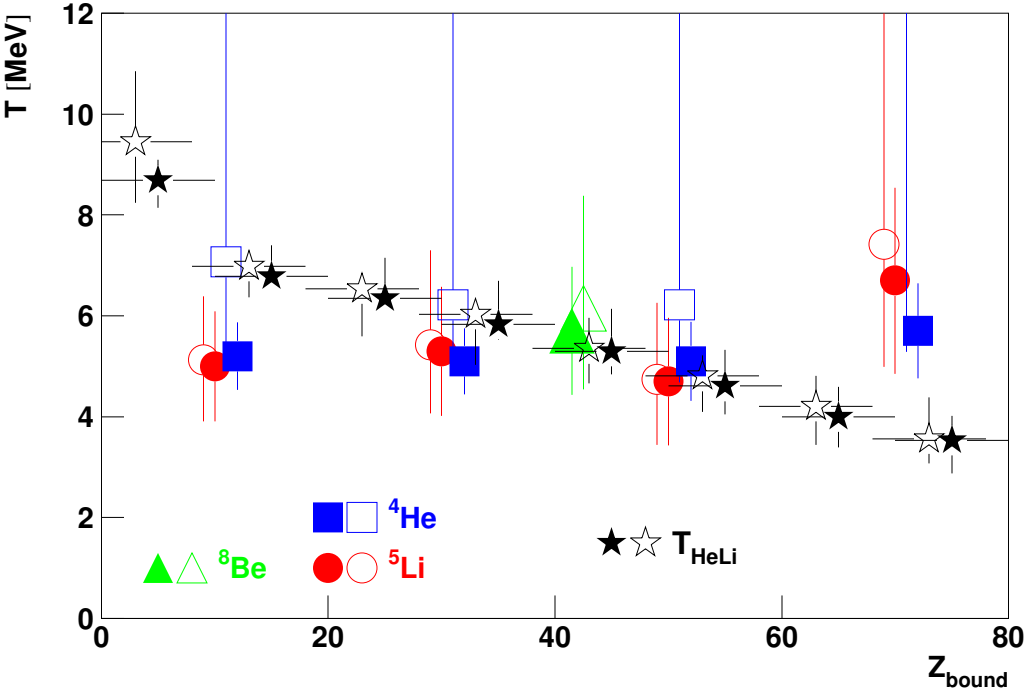Thermometer vor und nach Feeding-Korrektur